

校正証明書

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

顧客名 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター

品名	: ワイヤレスデータロガー	型式	: RTR-501L
製造番号	: 52B80B25	製造者	: 株式会社ティアンドデイ
校正日	: 2025年3月18日	管理番号	: AKFS24-7626
顧客管理番号: 治験1-B			

確認者



上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。

校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST (National Institute of Standards and Technology) などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

[illegible]

試験成績書

大阪市此花区高屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

品名	: ワイヤレスデータロガー	型式	: RTR-501L
製造番号	: 52B80B25	製造者	: 株式会社ティアンドデイ
校正日	: 2025年3月18日	管理番号	: AKFS24-7626
環境温度	: 25℃	校正者	: 元原 茂雄
調整	: あり ☒ なし ☐		

小村

上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。

校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST (National Institute of Standards and Technology) などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

〔使用標準器〕

品 名	製造者	管理番号
形 式	製造番号	有効期限
デジタル温度計/白金標準センサ	株式会社 サーモポート	MRI136
ADS-100-HQ / PTP-150	8001340/1501514/1501531/1501530/1501373/1501485	2025年4月9日


[校正結果]

試験点	判定基準	指示値	判定
[温度]			
5.0℃	4.5℃ ~ 5.5℃	5.3℃	良
*総合判定			良

[備 考]

トレーサビリティ体系図

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

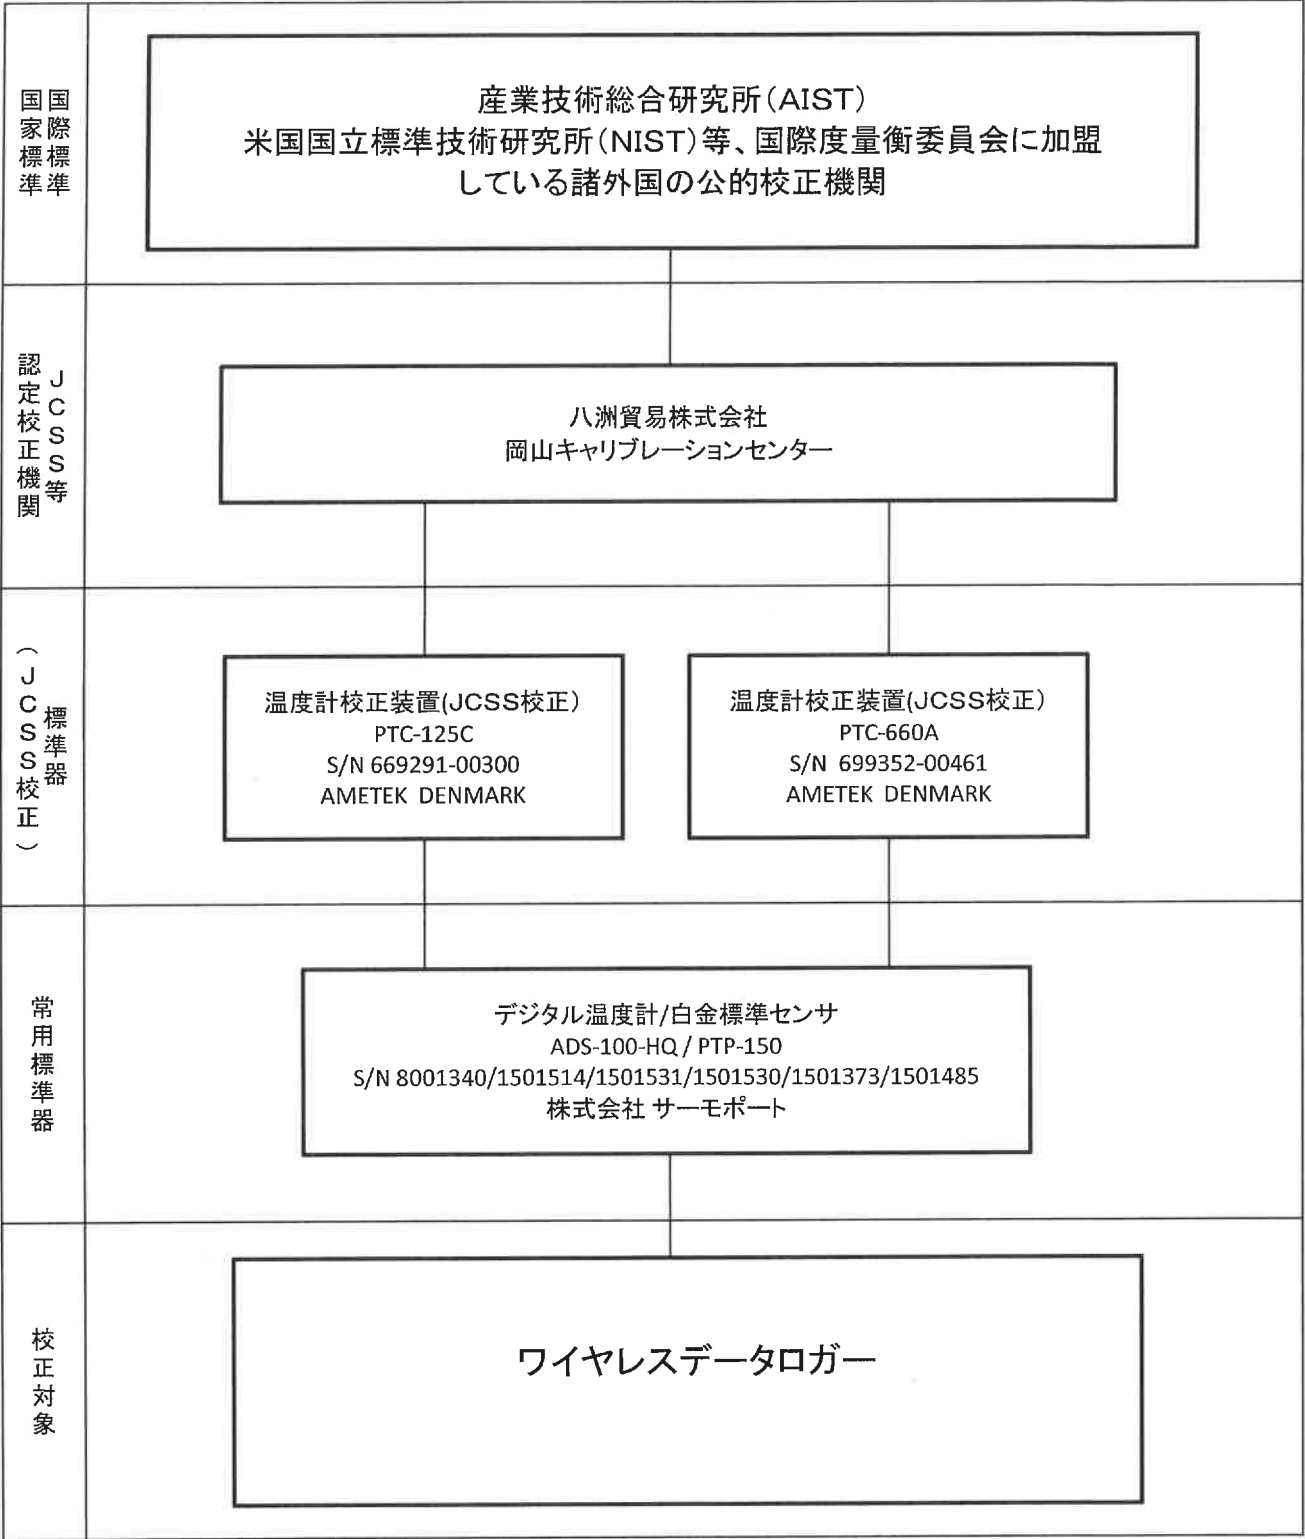

校正証明書

大阪市此花区高屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

顧客名 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター

品名	: ワイヤレスデータロガー	型式	: RTR-501L
製造番号	: 52B80B23	製造者	: 株式会社ティアンドデイ
校正日	: 2025年3月18日	管理番号	: AKFS24-7627
顧客管理番号: 治験2-B			

確認者



上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。
校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST (National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

「使用標準器」

[illegible]

試験成績書

大阪市此花区高屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

品名	: ワイヤレスデータロガー	型式	: RTR-501L
製造番号	: 52B80B23	製造者	: 株式会社ティアンドデイ
校正日	: 2025年3月18日	管理番号	: AKFS24-7627
環境温度	: 25℃	校正者	: 元原 茂雄
調整	: ☒ あり ☐ なし		

確認者



上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。

校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST(National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

品 名	製造者	管理番号
形 式	製造番号	有効期限
デジタル温度計/白金標準センサ	株式会社 サーマポート	MRI136
ADS-100-HQ / PTP-150	8001340/1501514/1501531/1501530/1501373/1501485	2025年4月9日


[校正結果]

試験点	判定基準	指示値	判定
[温度]			
5.0℃	4.5℃ ~ 5.5℃	5.0℃	良
*総合判定			良

[備 考]

トレーサビリティ体系図

大阪市此花区湯屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

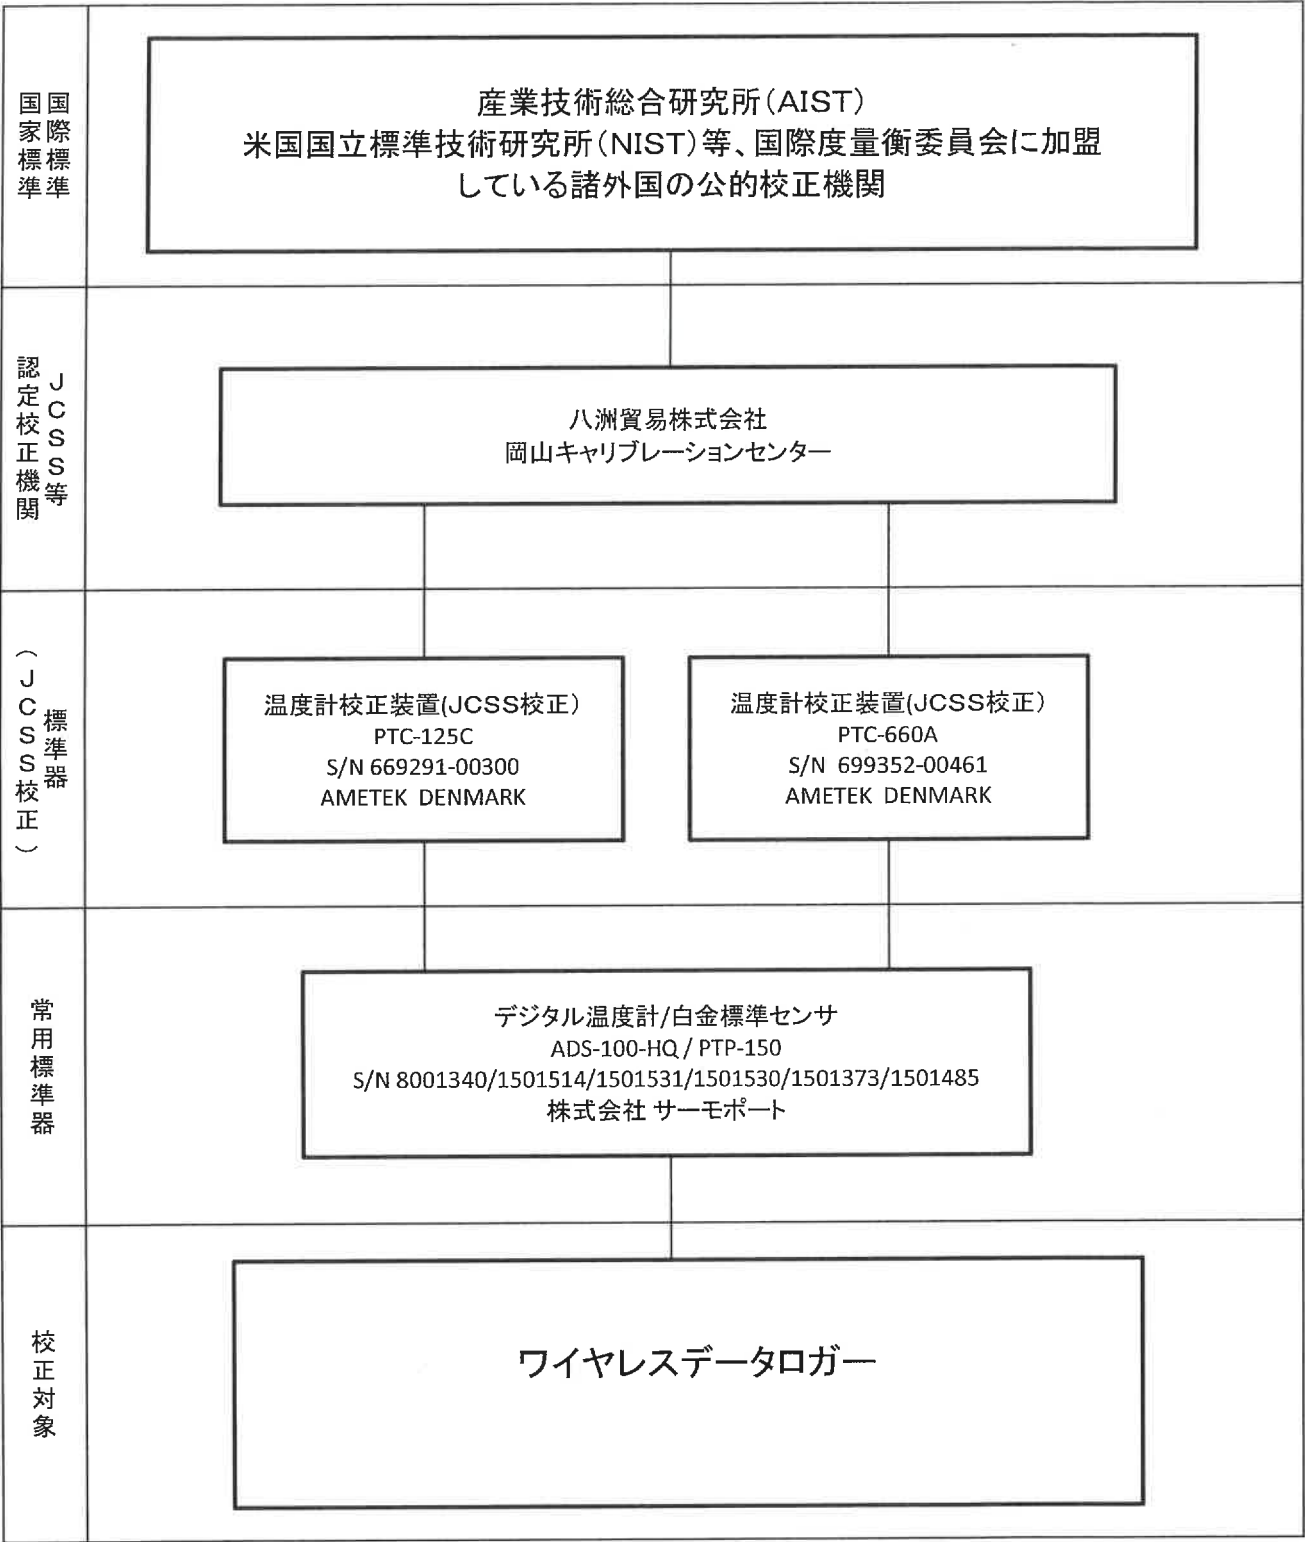

校正証明書

顧客名 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター

大阪市此花区島屋4-1-131

アズワン株式会社

サービス営業部

フィールドサービスグループ

品名 : ワイヤレスデータロガー 型式 : RTR-501L

製造番号 : 52B80B26 製造者 : 株式会社ティアンドデイ

校正日 : 2025年3月18日 管理番号 : AKFS24-7628

顧客管理番号: 治験3-B

確認者



上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。

校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST(National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

[illegible]

試験成績書

大阪市此花区高屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

品名	: ワイヤレスデータロガー	型式	: RTR-501L
製造番号	: 52B80B26	製造者	: 株式会社ティアンドデイ
校正日	: 2025年3月18日	管理番号	: AKFS24-7628
環境温度	: 25℃	校正者	: 元原 茂雄
調整	: ☒ あり ☐ なし		

確認者



上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。

校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST(National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

品 名	製造者	管理番号
形 式	製造番号	有効期限
デジタル温度計/白金標準センサ	株式会社 サーマポート	MRI136
ADS-100-HQ / PTP-150	8001340/1501514/1501531/1501530/1501373/1501485	2025年4月9日


[校正結果]

試験点	判定基準	指示値	判定
[温度]			
5.0℃	4.5℃ ~ 5.5℃	5.1℃	良
*総合判定			良

〔備考〕

トレーサビリティ体系図

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

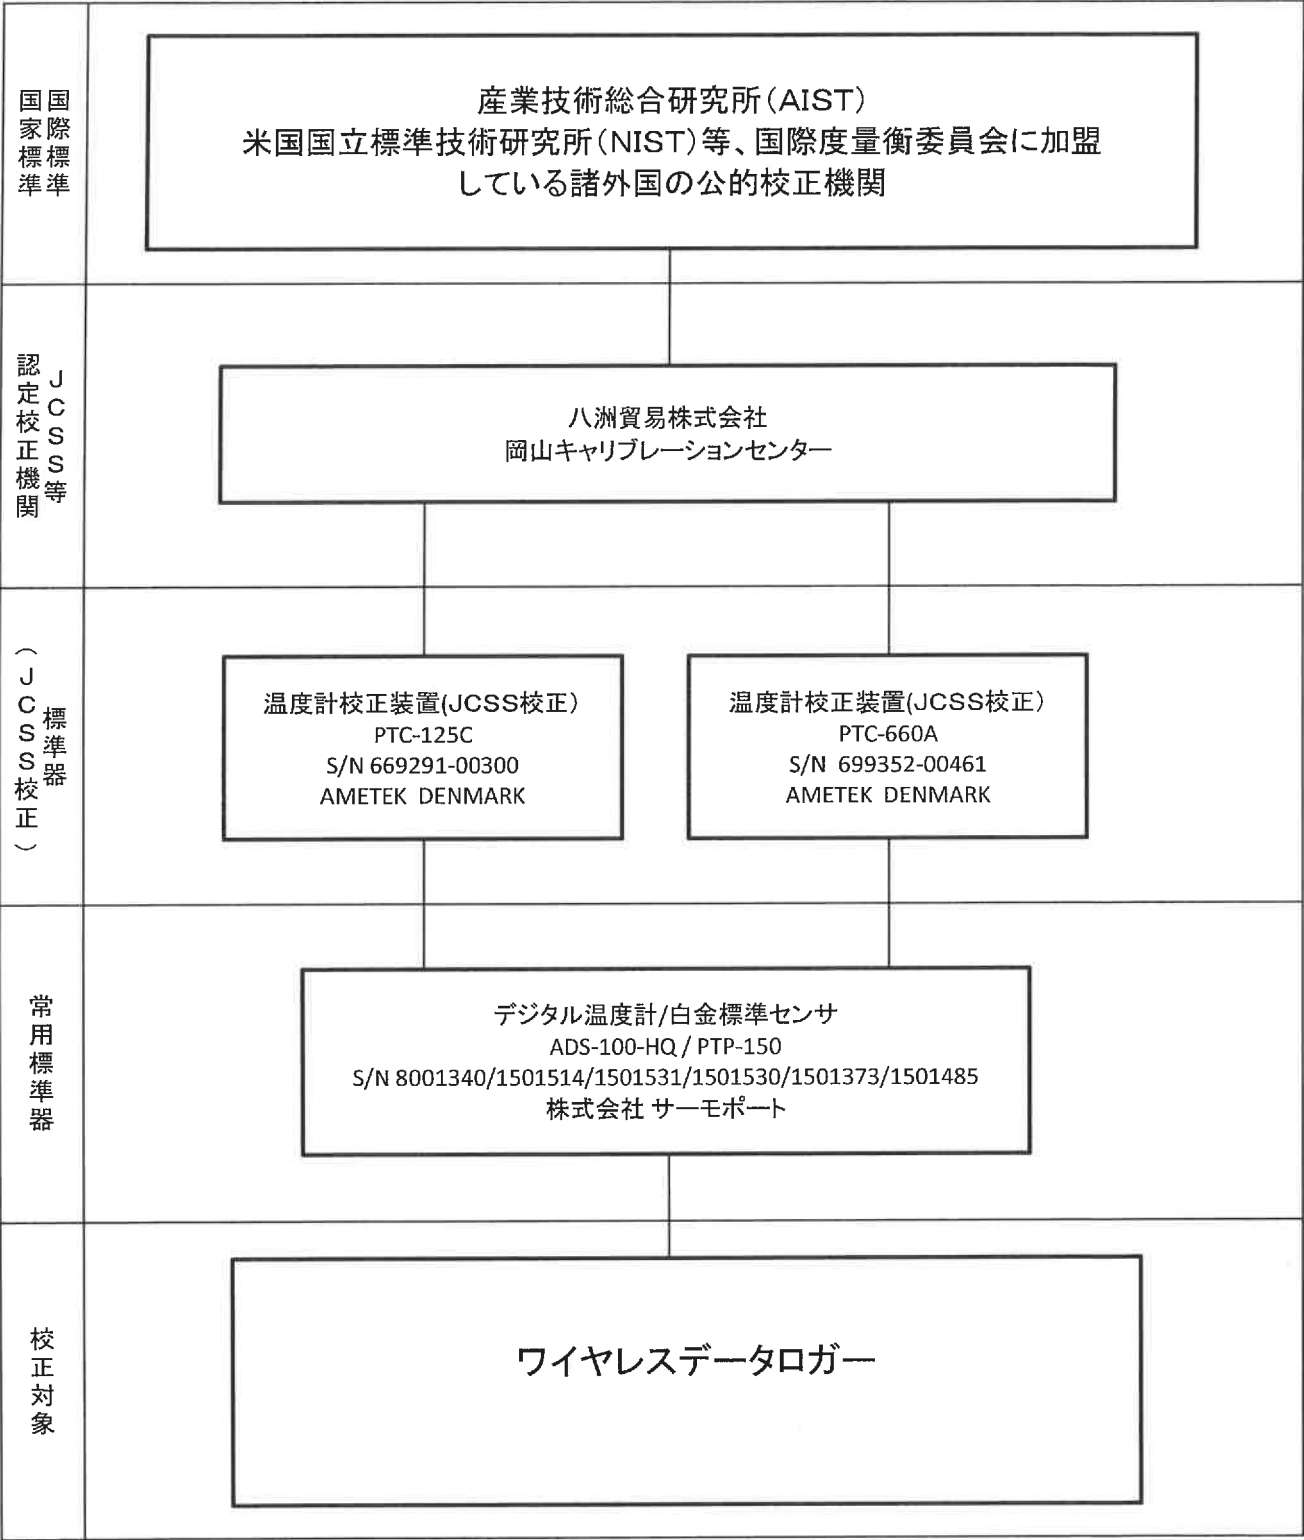

校正証明書

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

顧客名 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター

品名	: ワイヤレスデータロガー	型式	: RTR-501L
製造番号	: 52B8348B	製造者	: 株式会社ティアンドデイ
校正日	: 2025年3月18日	管理番号	: AKFS24-7629
顧客管理番号: 治験4-B			

確認者



上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。
校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST (National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

〔使用標準器〕

[illegible]

試験成績書

大阪市此花区高屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

品名	: ワイヤレスデータロガー	型式	: RTR-501L
製造番号	: 52B8348B	製造者	: 株式会社ティアンドデイ
校正日	: 2025年3月18日	管理番号	: AKFS24-7629
環境温度	: 25℃	校正者	: 元原 茂雄
調整	: ☒ なし		

確認者



上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。

校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST(National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

品 名	製造者	管理番号
形 式	製造番号	有効期限
デジタル温度計/白金標準センサ	株式会社 サーマポート	MRI136
ADS-100-HQ / PTP-150	8001340/1501514/1501531/1501530/1501373/1501485	2025年4月9日

[校正結果]

試験点	判定基準	指示値	判定
[温度]			
5.0℃	4.5℃ ~ 5.5℃	5.3℃	良
*総合判定			良

[備 考]

トレーサビリティ体系図

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

